



УТВЕРЖДАЮ
 Зам. директора ИФ КПИ
 М. В. Титаренко
 "07" марта 1984г.


УТВЕРЖДАЮ
 Зам. директора ВНИИЭП
 С. И. Цветков
 "07" марта 1984г.

ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний макета
 "Устройства автоматизированной поверки стрелочных приборов"

Житомир 5. Результаты исследований 7 марта 1984 г.

3.1. Как видно из таблицы 1 погрешность УАП.И не превышает 0,2%, что позволяет
 1. Объект исследования
 Макет "Устройства автоматизированной поверки стрелочных приборов" (УАПСП), разработанный и изготовленный Житомирским филиалом Киевского политехнического института по договору № 147 от 21 декабря 1982 г. (тема 0471 3665 70). Заказчик - Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов. Макет укомплектован блоком питания в соответствии с проектом от июля 1982г.

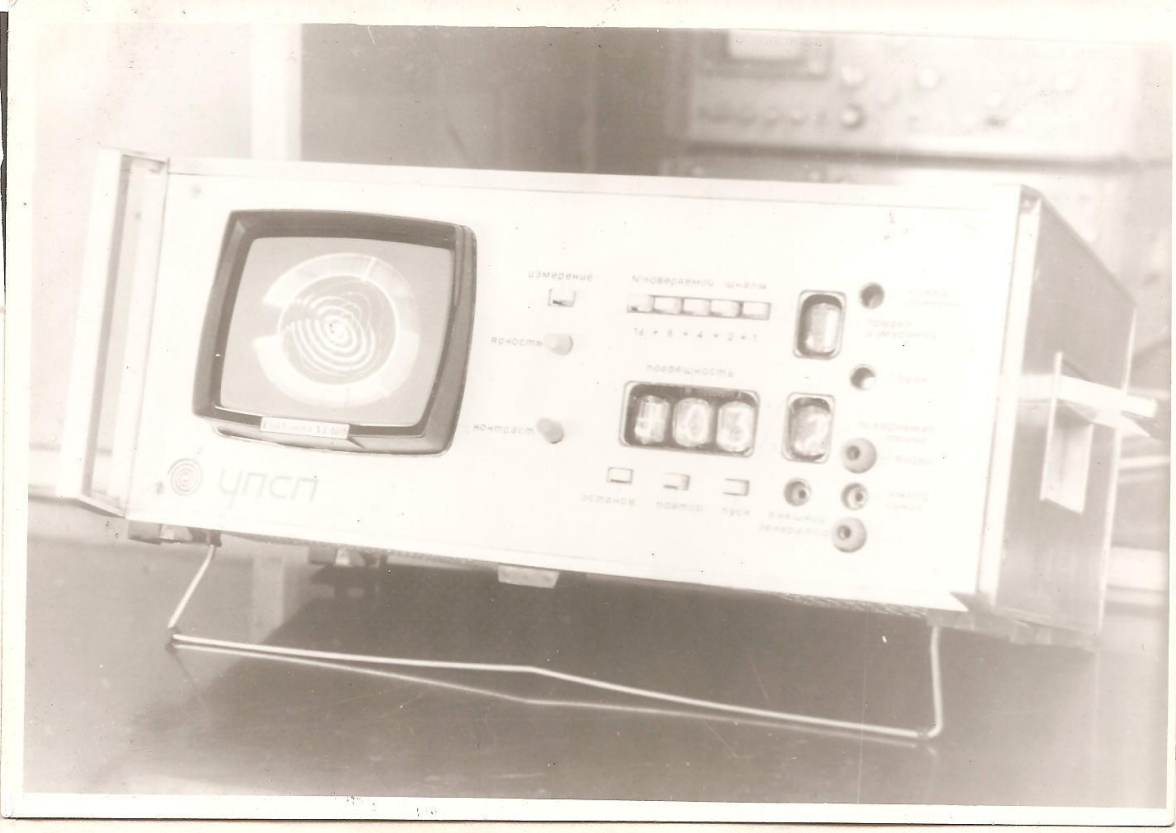

стиг-
 иборов
 омен-
 у-45-
 1. эко-
 емное
 по прог-
 а пог-
 оснад-
 мого
 вки
 метки